



# LÍNEA HIPODÉRMICOS



## *Calidad que da confianza*

**ISO 13485:2003/AC2009**  
gestión de calidad para plantas de  
manufactura de dispositivos médicos

**01:2008**  
gestión de calidad

Bisel primario

2o Bisel

3o Bisel


Punto de intersección  
de biseles

- **Acero inoxidable en Punta de Lanceta**  
Diseño de punta tribiselada para una suave punción que minimiza el dolor
- Pared ultra delgada para una administración más rápida y eficiente de medicamentos

- Tecnología **Ultra-Thin Wall**
- Diseño de punta tribiselada para una suave penetración, con mínimo trauma del tejido




Aguja normal

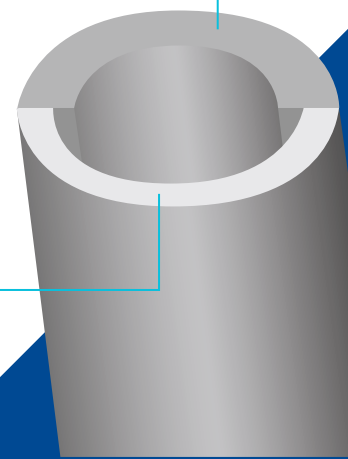Tecnología Ultra-Thin Wall




# RECOMENDACIONES

## Calibres y aplicaciones de nuestras agujas

								
<b>18 G</b>	<b>20 G</b>	<b>21 G</b>	<b>22 G</b>	<b>23 G</b>	<b>24 G</b>	<b>25 G</b>	<b>26 G</b>	<b>27 G</b>
Preparación de medicamentos	Soluciones aceitosas	Sueros y soluciones espesas	Sueros y soluciones NO espesas			Medicamentos ligeros		

Nuestras jeringas y agujas son estériles de acuerdo a la NOM-BB-8 mediante Óxido de Etileno (ETO) / Gamma

## Seguridad

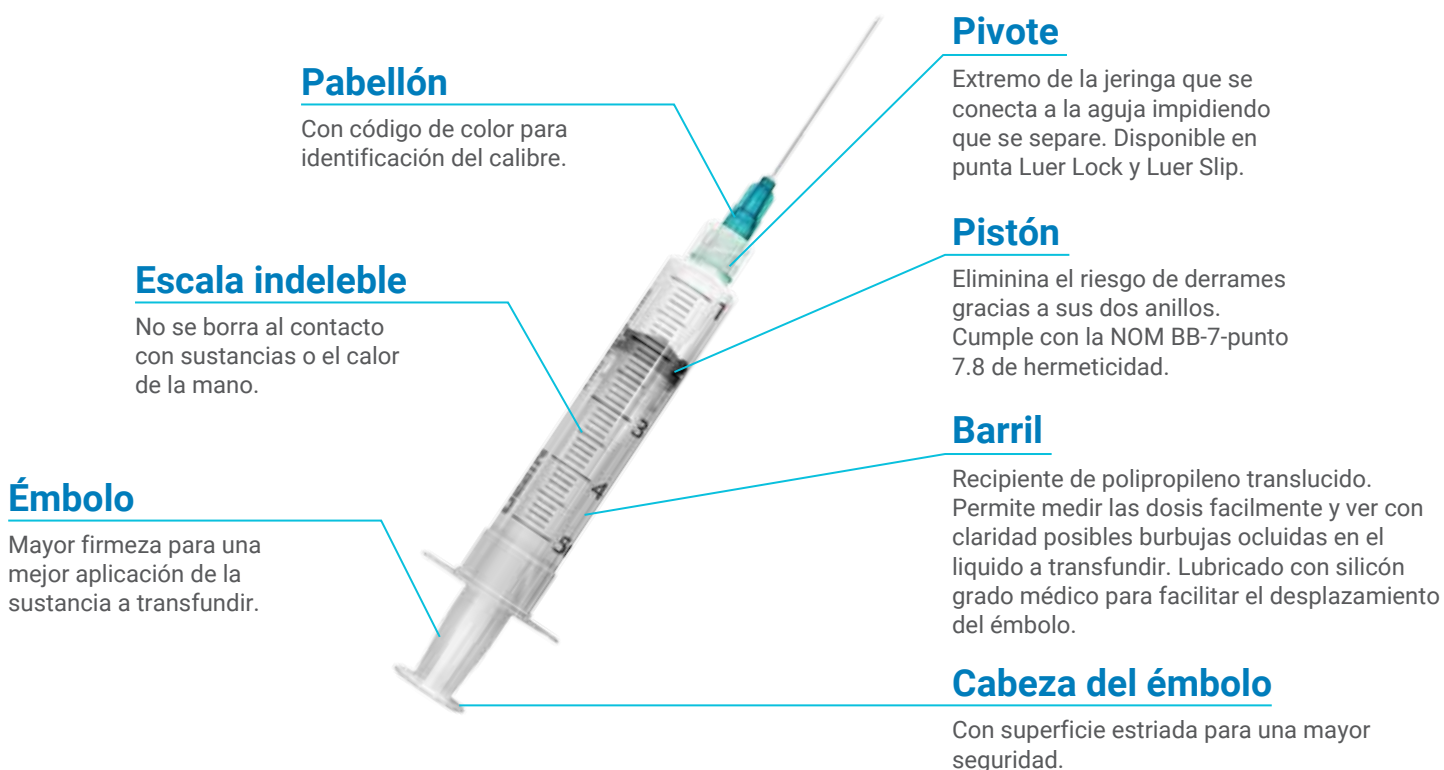

## Nipro Medical de México, S.A. de C.V.

**Oficinas Corporativas**  
Sierra Candela No. 111 Piso 11,  
Col. Lomas de Chapultepec,  
C.P. 11000 México, CDMX.  
Tel. : 52 (55) 5352.7100  
01800.112.4459

**Guadalajara**  
Av. Niños Héroes No. 2285,  
Col. Moderna, C.P. 44190,  
Guadalajara, Jalisco.  
Tel.: +52 (33) 3679.4357

**Puebla**  
Privada 9 B Sur No. 5126  
Col. Prados Agua Azul,  
C.P. 72430, Puebla, Puebla.  
Tel.: +52 (222) 211.4083  
+52 (222) 798.0180

**Monterrey**  
José Benítez No. 2186,  
Col. Obispaño, C.P. 64060,  
Monterrey, Nuevo León.  
Tel.: +52 (81) 1768.1734